保証書

本書は、お買い上げ頂いた製品が、厳密な検査基準に合格したものである事を証明します。
また、保証期間内に通常の使用状態で生じた故障に対して、弊社が無償修理又は交換の責任を負う事を保証します。
尚、保証期間後の修理は、有償となりますので予めご了承下さい。
●故障修理の場合は、弊社にご連絡下さい。
●修理の際は、必ず本書をご提示下さい。（ご提示のない場合は有償となりますのでご注意下さい。）
●本書は、日本国内においてのみ有効です。また再発行はいたしませんので大切に保管して下さい。

保証規定

①保証期間は、購入日より 1 年間です。
②この保証書は、通常の使用状態で生じた故障に限り無償保証を行うものです。
③修理時の発送費用はお客さまの実費負担となります。
④以下の場合は保証致しかねます。

■本書にご購入年月日、お名前、販売店印のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
■火災・浸水・不慮の事故による破損
■取扱説明書に記載のない使用方法の誤り、乱用による故障・破損または事故等
■一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
■車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
■弊社以外で行われた誤った修理または改造の為に生じた故障・破損または事故等
■付属品の紛失や劣化、その他消耗品類に関する事項
■ご使用後の傷、変色、汚れ及び移動や保管上の不備による損傷
■本書の提示がない場合
■本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is void out of Japan
＊商品改良のため予告なく仕様が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

商品名：AIR LEG BEAUTY ELEGANCE MODEL NEO（エアーレッグビューティ エレガンスモデル ネオ）	
ご購入年月日：　　年　　月　　日	
保証期間：お買い上げ日より 1 年間 （対象部分：本体のみ）	
お名前：	
ご住所：	
修理メモ：	販売店印：

V2-2013.11

トータル・アイ株式会社
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-7-28 TIG・ACTUS BUILDING 8F
カスタマーサポートセンター：**052-265-5763**（平日 10 時～ 17 時 土日・祝祭日を除く）

エアーレッグビューティ エレガンスモデル ネオ

AIR LEG BEAUTY
ELEGANCE MODEL NEO

取扱説明書

この度は、AIR LEG BEAUTY ELEGANCE MODEL NEO をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

■ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をよく理解されてから正しく安全にご使用ください。

■この説明書は手近なところに保管してください。
ご不明な点があればその都度読み直して正しくご使用ください。

『安全上の注意』 お使いいただく前に

＊ご使用の前にこの『安全上の注意』をよくお読みのうえ正しくお使いください。
＊ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、使用者や他の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
＊注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱により生じる可能性のある内容を『危険』『警告』『注意』の３つに区分しています。
すべて安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人が死亡または重傷を負うにいたることが想定される内容を示しています。

下記の項目に該当する方は、ご使用できません。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
(1) ペースメーカー等の体内埋込型医療電子機器をご使用の方
(2) 心電計等の装着型医療電子機器をご使用の方
(3) 人工心肺等の生命維持用医療電子機器をご使用の方
● 誤作動をまねくおそれがあります。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人が死亡または重傷を負う可能性があることが想定される内容を示しています。

下記の項目に該当する方は、ご使用できません。事故や体調不良を起こす恐れがあります。

(1) 生理中や妊娠している方
(2) 急性疾患の方
(3) 感染症疾患の方
(4) 悪性腫瘍のある方
(5) 心臓に障害のある方
(6) 貧血気味の方
(7) 熱の高い方（平熱以上）
(8) 皮膚知覚障害または皮膚に異常のある方
(9) 肌が弱い、皮膚がかぶれやすい、敏感肌の方
(10) アレルギー疾患のある方
(11) 血圧に異常のある方（180mmHg以上）
(12) 上記以外にとくに体に異常を感じている方
(13) お酒を飲まれている方
(14) 医師の治療を受けている方

●思わぬ事故や体調不良を起こす恐れがあります。
● 脚部や皮膚疾患の部位などには使用しないでください。
事故や体調不良を起こすおそれがあります。
● 他の治療器との同時使用や塗り薬との併用はしないでください。
気分が悪くなったり体調不良を起こす恐れがあります。
● 異常を感じた時またはアダプター等に不具合がある場合は直ちに使用を中止し、電源を抜いてください。事故の恐れがあります。
● ＡＣアダプターは付属品以外のものは使用しないでください。
感電してショートし発火する可能性があります。
● 本書に記載されている使用方法以外でのご使用はおやめください。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。
● 本品の用途以外でのご使用は絶対におやめください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人的傷害及び物的損害が発生することが想定される内容を示しています。

● 体調の悪いとき、過度に疲れているときには使用しないでください。
● 体や肌に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。
● 乳幼児や自分で意思表示ができない方に使用したり、またお子様の手の届く場所に保管しないでください。
思わぬ事故や体調不良を起こす恐れがあります。
● 浴室など湿度の高いところや入浴時、自動車の運転時には使用しないでください。
事故やトラブルにつながる恐れがあります。
● ご使用は１回 20 分以内としてください。
長時間の連続使用は、逆効果や体調不良を起こす恐れがあります。
● ファスナーやマジックテープを開けた状態でエアーを送らないでください。
故障や破裂の恐れがあります。
● 本品は精密電子部品で構成されていますので、不当な改造、分解や修理は絶対にしないで下さい。
故障や事故の原因となります。

《アダプターのお取扱いについて》

● 使用しない時は、本体とコンセントを繋いだままにせず必ずはずしてください。
● アダプターを分解したり、修理をしないで下さい。

ご使用上の注意

● ご使用前には本品に割れや異常がないかよく確認してください。
● 動きながら使用しないで下さい。破裂したり、ホースが外れる恐れがあり危険です。
● 本品に水をかけたり、濡れた手で取り扱わないで下さい。

保管・お手入れのご注意

● ご使用後は汚れを柔らかい布などでよく拭取り、保管して下さい。シンナー、ベンジン、溶剤は使用しないで下さい。
● 本品を水回りや高温多湿になる所、直射日光のあたる所、屋外に置かないで下さい。

本製品を廃棄する場合は、各自治体の指定に従って分別してください。

【セット内容】

A．ふくらはぎ、脚用ブーツ　２個
B．太もも用スリーブ２個
C．エアーパイプ　１式
D．コントローラー １個
E．ＡＣアダプター １個
（アダプター本体は写真には写っていません）
F．取扱説明書（保証書付）１冊
（写真には写っていません）

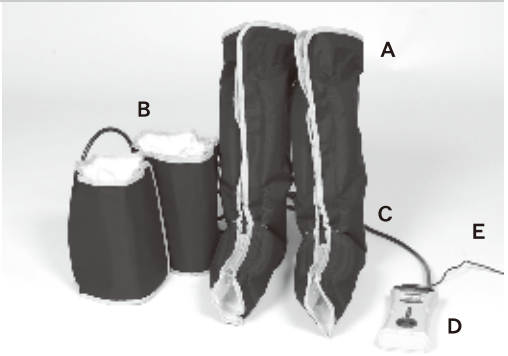

【コントローラーの説明】

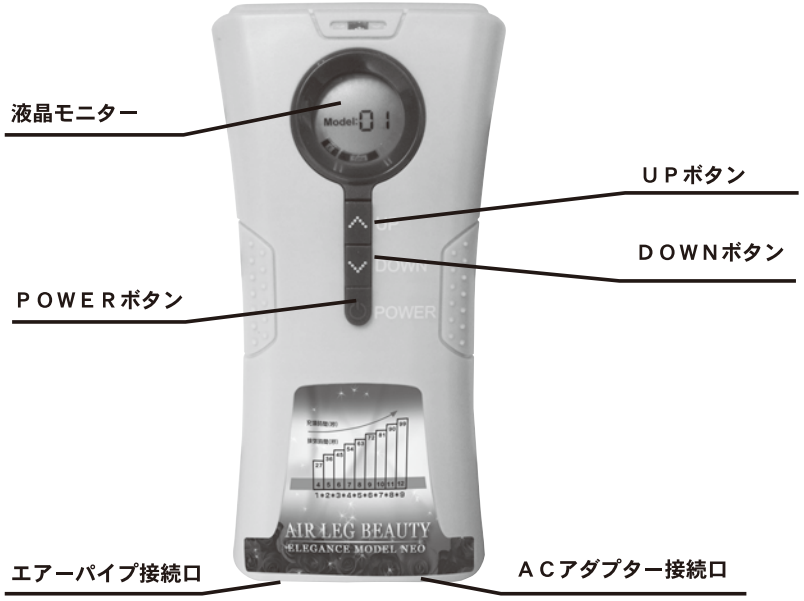

コントローラーの操作で脚部を気持ちよく締めつけたり解放したりする為の空気を送り込みます。
コントローラーのＵＰ/ＤＯＷＮボタンで、最も気持ち良いと感じる適正なレベル調整を行います。
＊使用中にうっかり眠らないようにご注意ください。
＊お子様には絶対に使用や操作をさせないでください。

コントローラーを作動させる電力は付属のＡＣアダプターもしくは単三乾電池４本をご使用ください。
＊ＡＣアダプター使用時は、必ず電池を抜いてください。
＊電池はアルカリ乾電池の使用をお勧めします。
＊コンセントは日本仕様の 100Ｖ 50/60Hz を必ずご使用下さい。
注意：本機は 20 分で自動的に運転を停止しますが、電源は切れませんので、ご使用後は必ず電源を切りプラグをコンセントからはずしてください。

【初めてお使いになる場合の注意事項】

開封後初めてお使いになる場合、ブーツ及び太もも用スリーブ内部が密着しており空気が注入されるまでに時間が掛かることがございます。
スタンバイモード後Model01～09のいずれかを１サイクル（20分）お体に装着せずに作動させて頂き、ブーツ及び太もも用スリーブ内部の密着を解いてから、ご使用ください。
それでも空気の注入が弱いと感じる場合はブーツ及び太もも用スリーブを手で軽く揉みほぐしてから再度、空気を注入してください。

【使用方法】

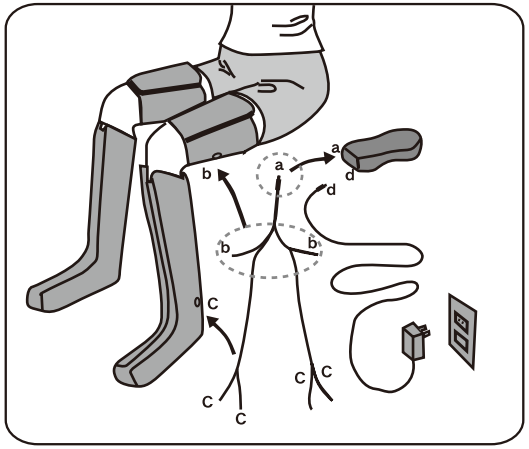

1. ふくらはぎ、脚用ブーツと太もも用スリーブを適正な部位に装着してください。
2. 図のようにエアーパイプを各部とコントローラーにしっかり接続してください。
3. コントローラーにＡＣアダプターを接続し、家庭用 100Ｖ電源にコンセントを接続してください。
   この時、必ずコントローラーの電源をＯＦＦにしておいてください。乾電池を使用する際は新品の同じブランドの電池を使用してください。異なるブランドや新しい電池と古い電池、アルカリ電池とその他の種類の電池などを混ぜて使わないでください。
4. エアーパイプやコントローラーが確実に接続されているか確認してください。又、スリーブのマジックテープがしっかり止まっている事、ブーツのジッパーがしまっている事を確認してください。
5. コントローラーの POWER ボタンを押すと電源が入り、液晶画面が表示されます。（自動的にModel：01が表示されスタンバイモードがスタートします）再度ＰＯＷＥＲボタンを押すと電源が切れます。
6. 使用時はソファに座ったり、横になって使用してください。この時、エアーパイプやコードが絡んだり外れたりしないよう気を付けてください。
7. ふくらはぎ、脚用ブーツと太もも用ブーツは同時に使用できます。又、特定の部位だけに使用する事もできますがコントローラーに接続されているエアパイプから空気が漏れないよう工夫してください。

＊空気圧が弱いと感じる場合、内側の汗が気になる場合は薄手のタオルや綿のソックスを着用してご使用ください　。

設　定

コントローラーのＵＰ／ＤＯＷＮボタンで９段階の強弱調整ができます。
電源を入れると液晶画面にModel：01が表示されスタンバイモード（エアー充填54秒・排気７秒）が始まります。その後Model：01（充填27秒、排気４秒）が開始します。ＵＰボタンを押すたびに液晶画面のModel数値が上がりエアー圧が強くなります。心地良いと思われる設定でご使用ください。強すぎると感じる場合はＤＯＷＮボタンを押してエアー圧を弱くしてください。

※エアー圧が強くなるとは、エアー充填時間が長くなる事を指しています。

Model	エア充填時間	排気時間
01	約 27 秒	約 4 秒
02	約 36 秒	約 5 秒
03	約 45 秒	約 6 秒
04	約 54 秒	約 7 秒
05	約 63 秒	約 8 秒

Model	エア充填時間	排気時間
06	約 72 秒	約 9 秒
07	約 81 秒	約 10 秒
08	約 90 秒	約 11 秒
09	約 99 秒	約 12 秒

液晶モニター

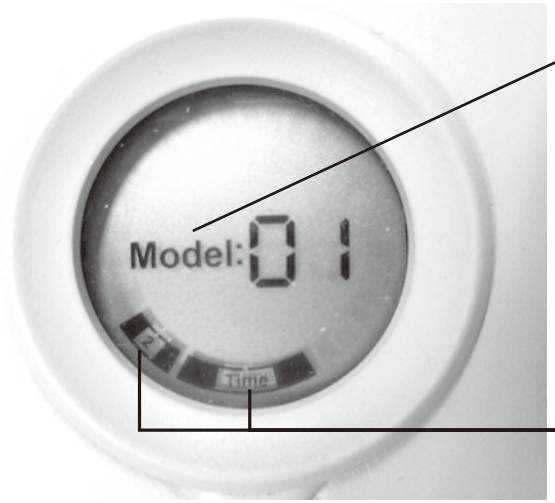

【Model】⇒レベル
（例）Model：01→レベル１

【Time】
２の点滅が止まる→2 分経過
４の点滅が止まる→4 分経過
〜
20 の点滅が止まる→20 分経過
＊自動停止機能によりプログラムが終了し液晶画面が消えます

動作途中にエアー圧のレベルの変更を行いますとタイマー表示が「0」になり、
新たにレベルを設定されたところから約20分後に動作が停止します。

お手入れ方法

（ふくらはぎ、脚用ブーツ・太もも用スリーブ）
ドライクリーニングや洗濯は絶対にお止めください。
通常のお手入れは中性洗剤で軽く拭いてください。
汚れがひどい時は温水で手洗いして陰干ししてください。
＊その場合、パイプを必ず外してコントローラー部分を濡らさないでください。
＊長時間使用しない時は内部の乾電池を必ず外して保管してください。

製品仕様

製品名	AIR LEG BEAUTY ELEGANCE MODEL NEO
型番	TI-3100
電源	AC アダプター ／ 単三形乾電池(1.5V)×4 本
ＡＣアダプター	INPUT : AC100V 50/60Hz 8VA OUTPUT : DC9V 200mA
消費電力	2.7-3W
消費電流	450-500mA
空気圧	0.03-0.08Mpa
タイマー	20 分自動停止機能
材質	コントローラー：ＡＢＳ ブーツ・スリーブ：外側 ナイロン 70D 内側 ゴム・ポリエステル・PVC パイプ：PVC

エアーレッグビューティ エレガンスモデル ネオ

AIR LEG BEAUTY
ELEGANCE MODEL NEO

オプションキットの使い方

本書では「エアーレッグビューティ エレガンスモデル ネオ」の「オプションキット」（太もも用スリーブ専用エアーパイプ 1本、脚用ブーツ専用エアーパイプ 1本）の接続方法をご案内しております。
必ず製品本体の取扱説明書もよくお読み頂き、ご使用方法・注意事項を守って正しくご使用ください。

太もも用スリーブ専用エアーパイプ

太もも用スリーブだけを使いたい時に

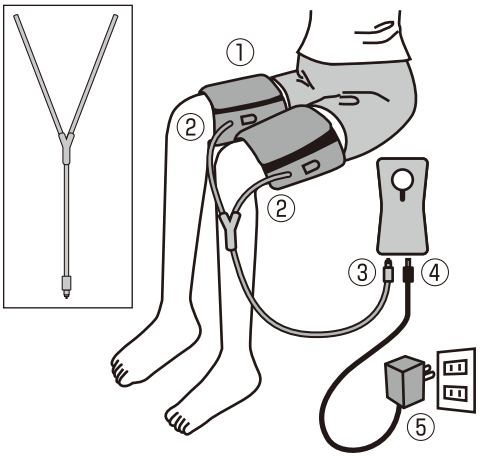

①太もも用スリーブを適正な部位に装着してください。
②「太もも用スリーブ専用エアーパイプ」の2本に分かれた先端を、それぞれの太もも用スリーブに1本ずつ接続します。
③「太もも用スリーブ専用エアーパイプ」の接続部をコントローラーのエアーパイプ接続口にしっかり差し込みます。
④ACアダプターの接続端子をコントローラーのAC アダプター接続口に差し込みます。
⑤ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。
⑥取扱説明書の記載にしたがって操作してください。

脚用ブーツ専用エアーパイプ

脚用ブーツだけを使いたい時に

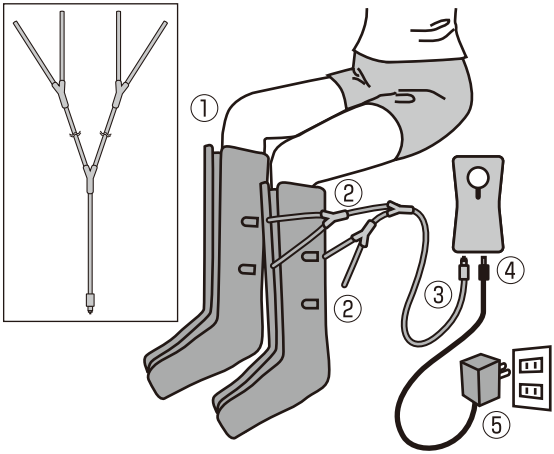

①脚用ブーツを適正な部位に装着してください。
②「脚用ブーツ専用エアーパイプ」の4本に分かれた先端を、それぞれの脚用ブーツに2本ずつ接続します。
③「脚用ブーツ専用エアーパイプ」の接続部をコントローラーのエアーパイプ接続口にしっかり差し込みます。
④ACアダプターの接続端子をコントローラーの AC アダプター接続口に差し込みます。
⑤ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。
⑥取扱説明書の記載にしたがって操作してください。

※上記は説明のための略図です。部品の形状、大きさ・長さの比率は実物とは異なります。
※太もも用スリーブと脚用ブーツを同時にご使用になるときは、本体付属のエアーパイプ一式に太もも用スリーブと脚用ブーツを接続してご使用ください。

オプションキット

「太もも用スリーブ専用エアーパイプ」「脚用ブーツ専用エアーパイプ」が付いています。ケアしたい場所だけ使えてとっても便利！

太もも用スリーブ専用エアーパイプ 1本

太もも用スリーブだけを使いたい時に

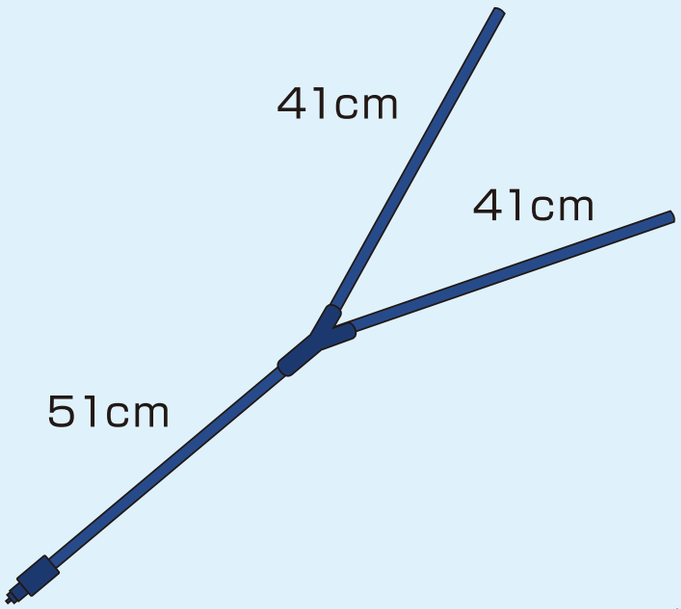

脚用ブーツ専用エアーパイプ 1本

脚用ブーツだけを使いたい時に